


SY - osan räjäytystyöt alkavat 12.11.2018. Työstä aiheutuu tärinähaittaa, minkä vuoksi Biomedicum A-siiven sekä Biomedicum 2 työmaan puoleiset tärinäherkät laitteet suojataan tärinävaimentimilla.

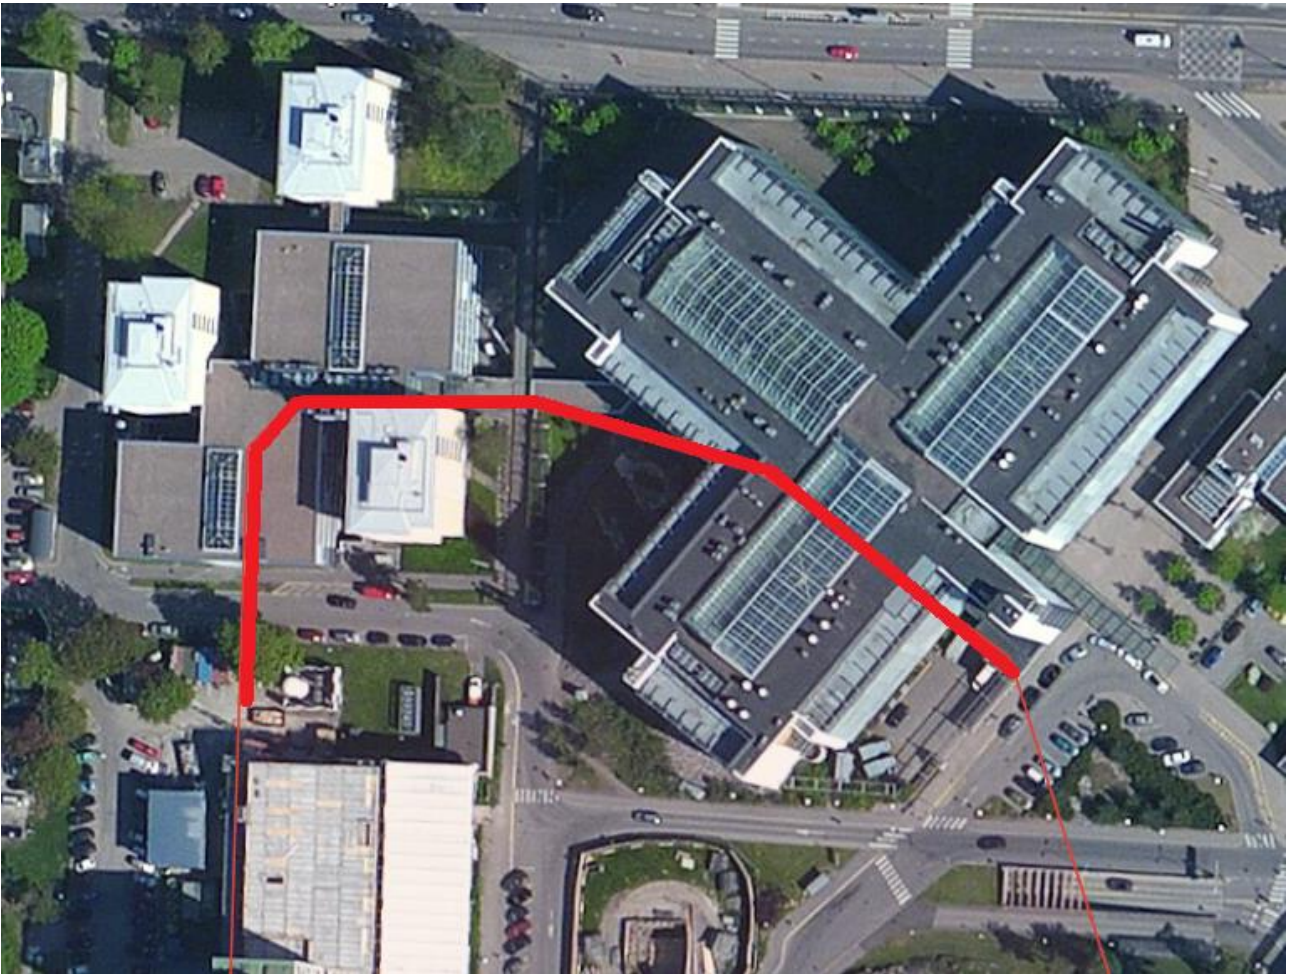

Tärinävaimentimien asennustyöt aloitetaan tiistaina 30.10.2018.

Tärinävaimennuksen asennustyössä laitteesta vastaavan tulee olla mukana varmistamassa, että laite on kytkettyä pois päältä tai se on ajettuna sellaiseen tilaan, että laitetta voidaan nostaa ja eristimet asentaa laitteen jalkojen alle.

Työlle voidaan sopia myös ennalta ajankohta, jolloin työ voidaan tehdä. Pyydämme teitä sopimaan ajan sähköpostitse osoitteessa juha.tuovinen@louhintakonsultit.fi